



WWW.ESSEDIEMME.IT

## ESSEDIEMME S.R.L.

Termografia - Certificazioni energetiche  
Sicurezza - Acustica - Misure di vibrazioni

Sede legale: Via Salaria 83 - 00198 Roma

Cell + 39 3286163659

Fax +39 1786073756

Email: info@essediemme.it

P.IVA e C.F. 06483631005

### CONFRONTO SU OGGETTO A DISTANZA RAVVICINATA (2 METRI) TRA THERMACAM P660 (SENSORE CON RISOLUZIONE DI 640x480 PIXEL) E THERMACAM P65 (SENSORE CON RISOLUZIONE DI 320x240 PIXEL)

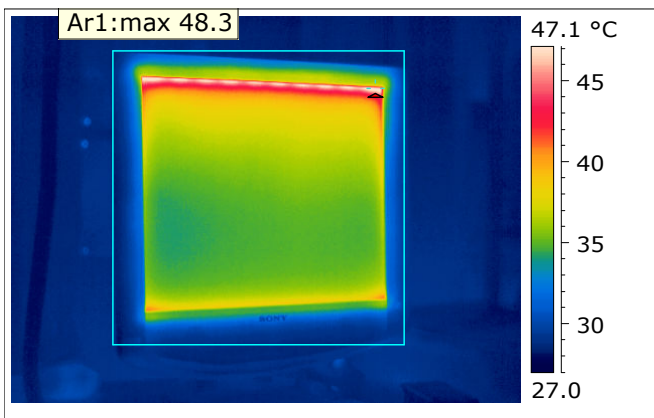


Immagine n. 1

#### Etichetta

IR: Tipo di termocamera

Ar1: Max

Ar1: Min

Ar1: Max - Min

Ar1: Media

#### Valore

**P660**

48.3 °C

28.0 °C

20.4 °C

34.6 °C




Immagine n. 2

#### Etichetta

IR: Tipo di termocamera

Ar1: Max

Ar1: Min

Ar1: Max - Min

Ar1: Media

#### Valore

**P65 PAL**

48.3 °C

27.2 °C

21.0 °C

33.6 °C



WWW.ESSEDIEMME.IT

## ESSEDIEMME S.R.L.

Termografia - Certificazioni energetiche  
Sicurezza - Acustica - Misure di vibrazioni

Sede legale: Via Salaria 83 - 00198 Roma  
Cell + 39 3286163659  
Fax +39 1786073756  
Email: info@essediemme.it  
P.IVA e C.F. 06483631005

### CONFRONTO SU OGGETTO A MEDIA DISTANZA (50 METRI) TRA THERMACAM P660 (SENSORE CON RISOLUZIONE DI 640x480 PIXEL) E THERMACAM P65 (SENSORE CON RISOLUZIONE DI 320x240 PIXEL)




Immagine n. 3

Etichetta	Valore
IR: Tipo di termocamera	<b>P660</b>
Ar1: Max	62.1 °C
Ar1: Min	26.8 °C
Ar1: Max - Min	35.3 °C
Ar1: Media	43.0 °C




Immagine n. 4

Etichetta	Valore
IR: Tipo di termocamera	<b>P65 PAL</b>
Ar1: Max	59.0 °C
Ar1: Min	26.8 °C
Ar1: Max - Min	32.2 °C
Ar1: Media	46.0 °C



WWW.ESSEDIEMME.IT

## ESSEDIEMME S.R.L.

Termografia - Certificazioni energetiche  
Sicurezza - Acustica - Misure di vibrazioni

Sede legale: Via Salaria 83 - 00198 Roma  
Cell + 39 3286163659  
Fax +39 1786073756  
Email: info@essediemme.it  
P.IVA e C.F. 06483631005

### CONFRONTO SU OGGETTO A MEDIA-LUNGA DISTANZA (100 METRI) TRA THERMACAM P660 (SENSORE CON RISOLUZIONE DI 640x480 PIXEL) E THERMACAM P65 (SENSORE CON RISOLUZIONE DI 320x240 PIXEL)




Immagine n. 5

#### Etichetta

IR: Tipo di termocamera

Ar1: Max  
Ar1: Min  
Ar1: Max - Min  
Ar1: Media

#### Valore

ThermaCAM  
P660  
64.9 °C  
25.3 °C  
39.5 °C  
40.0 °C




Immagine n. 6

#### Etichetta

IR: Tipo di termocamera

Ar1: Max  
Ar1: Min  
Ar1: Max - Min  
Ar1: Media

#### Valore

P65 PAL  
62.8 °C  
25.0 °C  
37.8 °C  
38.2 °C

**CONFRONTO SU OGGETTO A LUNGA DISTANZA (150 METRI) TRA THERMACAM P660 (SENSORE CON RISOLUZIONE DI 640x480 PIXEL) E THERMACAM P65 (SENSORE CON RISOLUZIONE DI 320x240 PIXEL)**

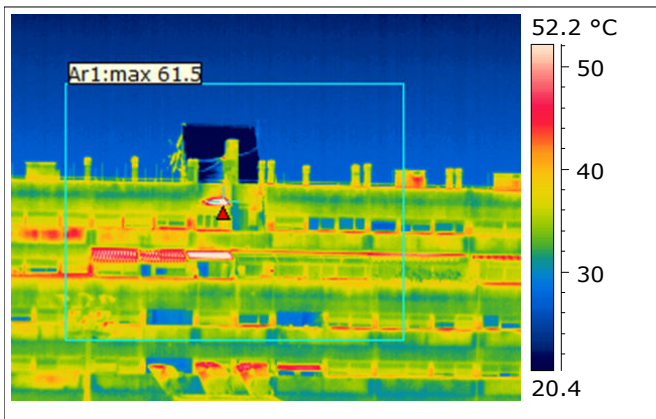


Immagine n. 7

<b>Etichetta</b>	<b>Valore</b>
IR: Tipo di termocamera	<b>P660</b>
Ar1: Max	58.4 °C
Ar1: Min	28.0 °C
Ar1: Max - Min	30.4 °C
Ar1: Media	35.0 °C

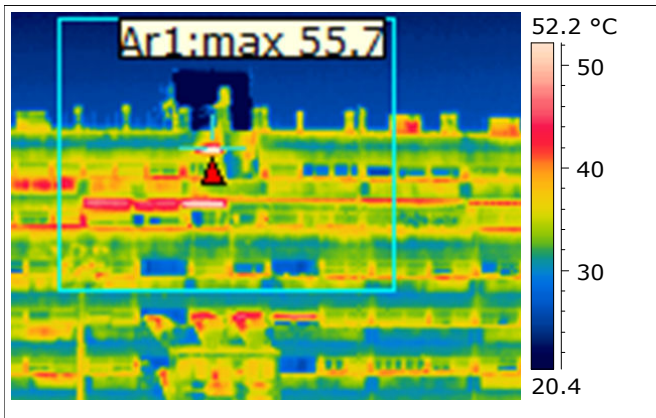


Immagine n. 8

<b>Etichetta</b>	<b>Valore</b>
IR: Tipo di termocamera	<b>P65 PAL</b>
Ar1: Max	56.0 °C
Ar1: Min	26.7 °C
Ar1: Max - Min	29.2 °C
Ar1: Media	33.4 °C